

Комплекс программно-аппаратный DIMESO для дистанционного медосмотра

«Телемедсервис»
8 800 100 43 70
info@tele-m.com



Подключено к МЕДБАНК.РФ

РУ : РЗН 2020/10726
ТУ : 26.60.12 - 001 - 51082790 - 2018
Габариты : 335 x 413 x 337 мм
Вес : 9,5 кг
Гарантия: 2 года

- ✓ Фотофиксация всех этапов прохождения медицинского осмотра
- ✓ SMS - уведомление о наличии признаков опьянения
- ✓ Возможность использования любых типов СКУД-карт
- ✓ Ведение журнала учета ПРМО в электронном виде
- ✓ Видеоконтроль выхода сотрудника в смену
- ✓ Интеграция с системами управления доступом, 1С, ERP системы
- ✓ Работа от выделенной интернет-сети и от модема
- ✓ Печать стикера с результатом техосмотра

1 Идентификация:


- Карта СКУД
- Телефон
- Логин и пароль

2 Измерение:

- Опрос жалоб
- Пары алкоголя
- Артериальное давление
- Пульс
- Температура тела
- Осмотр видимых покровов

3 Печать

- Результатов медосмотра
- Результатов техосмотра

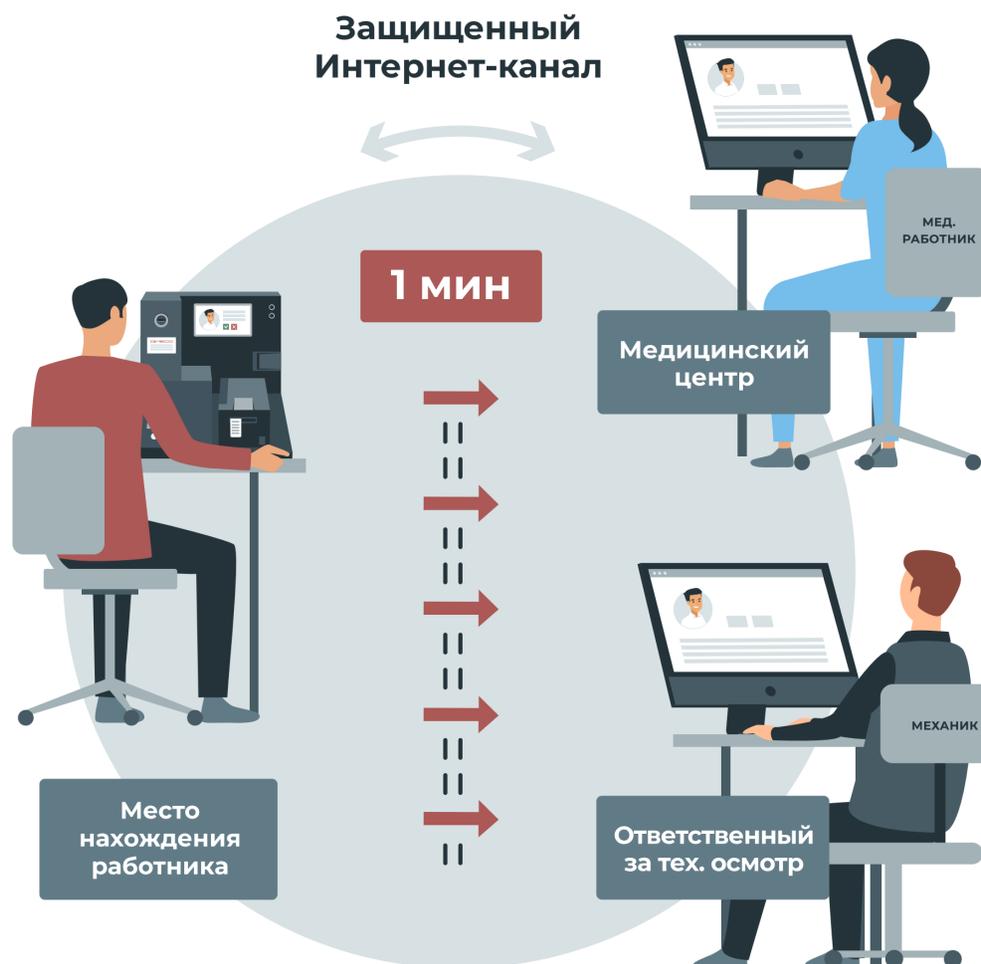

- 1 Идентификация пациента по личным данным и фотографиям
- 2 Контроль медицинских показателей
- 3 Заключение о допуске с ЭЦП


- 1 Контроль ТС
- 2 Внесение показателей одометра
- 3 Подпись результатов ЭЦП



Проверка на наличие алкоголя



Измерение давления и пульса

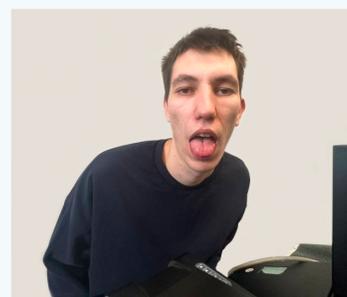

Измерение температуры и контроль слизистых

Тестовый Водитель Компании прошел предрейсовый медицинский осмотр к исполнению трудовых обязанностей допущен 06-09-2023 13:44:29 (МСК)
Медработник:
Тест_Проверка Медика
Тестовое представительство
Лицензия №_ТестоваяЛицензия от 10-10-2020 г., бессрочно
УКЭП 8ВВ5904375А359Е4
Осмотр № 1 6664633 МЕДБАНК.РФ

Для ТС Volvo S40 гос.номер С333СС77 выпуск на линию разрешен 06-09-2023 11:49:12 (МСК)
Отв.лицо:
Тестовый Механик Компании
ЭЦП E5218В799F47583А
Осмотр № 5 МЕДБАНК.РФ

Печать стикеров с допуском к работе и результатом техосмотра

Отчеты для руководства

Динамика снижения недопусков

- Пульс
- Температура
- Диастолическое давление
- Подозрение на неадекватность
- Систолическое давление
- Алкоголь



Информация по количеству ПРМО на точках выпуска

